

INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA IBMETRO



INFORME FINAL

ENSAYO DE APTITUD

Código: EQI-008/2025 - 02

**“DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS EN MINERAL
DE ESTAÑO”**

MATRIZ: MINERAL DE ESTAÑO

DIRECCIÓN DE METROLOGÍA
INDUSTRIAL Y CIENTÍFICA – DMIC

Fecha de emisión: 2025-11-05

Elaborado por:	Julián Ernesto Morales Alarcón	Fecha:	2025-09-17
Revisado y aprobado por:	Jose Luis Gonzales Quino	Fecha:	2025-09-18
Informacion actualizada en:			2025-11-05

El presente documento ha sido elaborado en la Dirección de Metrología Industrial y Científica del Instituto Boliviano de Metrología

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 2 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

POLÍTICA DEL IBMETRO PARA EL USO DE INFORMES DE ENSAYO DE APTITUD

La política del Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) como proveedor de Ensayos de Aptitud que cumple con los requisitos de la norma ISO 17043:2023 se centra en asegurar que los informes finales de resultados de Ensayos de Aptitud se utilicen como una herramienta confiable para evaluar y mejorar la competencia técnica de los laboratorios participantes. El IBMETRO se compromete a proporcionar informes claros, imparciales y basados en evidencia, que incluyan los datos necesarios para la toma de decisiones internas de calidad, preservando la confidencialidad y la integridad de la información individual de cada participante.

Los informes finales en su versión preliminar se constituyen en versiones previas cuyo objetivo es que los participantes verifiquen la información contenida y realizar cambios en los mismos según sea necesario. Algunos cambios pueden afectar a las evaluaciones de desempeño de los participantes, por esta razón los informes finales en su versión preliminar no sustituyen al Informe Final.

Un Informe Final, una vez publicado en nuestra página web, no podrá ser cambiado ni se aceptarán observaciones sobre el contenido, salvo que el Sistema de Gestión de Calidad del IBMETRO así lo requiera.

El informe final del Ensayo de Aptitud será enviado a cada participante vía correo electrónico y será publicado en la página web del IBMETRO (www.ibmetro.gob.bo).

Los participantes y partes interesadas pueden solicitar una impresión oficial del Ensayo de Aptitud, el mismo tendrá un costo adicional.

El IBMETRO se reserva el derecho de utilizar la información del presente informe de Ensayo de Aptitud como fuente para publicaciones o labores didácticas, siempre que se respete el anonimato de los participantes.

ACTUALIZACION DEL INFORME DE ENSAYO DE APTITUD

*Este informe con código **EQI-008/2025 - 02** reemplaza al informe con código **EQI-008/2025 - 01** en su totalidad, quedando **ANULADO** el informe con código **EQI-008/2025 - 01**. Los cambios realizados son los siguientes:*

Código de informe	Fecha emisión	Modificación realizada
EQI-008/2025 - 02	2025-11-05	- En la página 1 se modificó la fecha de elaboración de 2024-09-18 a 2025 -09-17 y revisión de 2024-09-17 2025-09-18. - En la página 2 se amplió la definición de informe final en su versión preliminar.

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 3 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

Índice

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	ORGANIZACIÓN	4
3.	UNIDAD DE COORDINACIÓN	4
4.	OBJETIVOS.....	5
5.	ACTIVIDADES DE PROVEEDORES EXTERNOS	5
6.	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO.....	5
7.	HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO	5
8.	VALORES DE REFERENCIA	6
9.	CONFIDENCIALIDAD	8
10.	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.....	8
11.	RESULTADOS	9
11.1.	Estaño en Mineral de Estaño 1	9
11.2.	Estaño en Mineral de Estaño 2	11
11.3.	Azufre en Mineral de Estaño 2	13
11.4.	Zinc en Mineral de Estaño 2	15
11.5.	Estaño en Mineral de Estaño 3	17
12.	LABORATORIOS PARTICIPANTES.....	19
13.	OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS LABORATORIOS ..	20
14.	CONCLUSIONES.....	20
15.	APELACIONES.....	20
16.	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	21

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 4 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

1. INTRODUCCIÓN

IBMETRO viene organizando rondas de Ensayo de Aptitud dirigido a apoyar a los laboratorios u organismos de inspección que realizan ensayos en las matrices de minerales de Estaño con la finalidad de mejorar las capacidades analíticas y la gestión en organismos de inspección y laboratorios bolivianos.

Para que un laboratorio u organismo de inspección sea considerado competente es necesario que asegure la confiabilidad de sus resultados. La participación regular en programas de ensayos de aptitud es uno de los medios disponibles para que demuestren su desempeño.

La participación en estos programas es un requisito establecido en las normas de competencia técnica para laboratorios de ensayo. También es un requisito exigido por la Dirección Técnica de Acreditación en Bolivia (DTA-CRI-015) y en algunos casos puede ser un requerimiento establecido en la legislación vigente.

2. ORGANIZACIÓN



Dirección de Metrología Industrial y Científica
 Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO
 Unidad de Metrología Química
 La Paz, Municipio de Achocalla, Av. Illimani, Z. Valle Hermoso
 (+591) 72015382; (+591) 71543136
www.ibmetro.gob.bo

3. UNIDAD DE COORDINACIÓN

COMITÉ TÉCNICO – CIENTÍFICO

Lic. Julian Morales – Coordinador Técnico y Responsable estadístico del ensayo de aptitud

Lic. Jose Luis Gonzales – Supervisor de la Unidad de Metrología Química

Ing. Henry Paco Marino – Director de Metrología Industrial y Científica

PERSONAL DE APOYO

Ing. Yamil Acho – Colaborador técnico

Lic. Jimena Torrez – Colaborador técnico

Lic. Gilda Cruz Ochoa - Colaborador Técnico

Lic. Fernando Huanca - Colaborador Técnico

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 5 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

4. OBJETIVOS

- Presentar los resultados de la evaluación del desempeño de los laboratorios participantes en el ensayo de aptitud EQI-008-2025 "DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS EN MINERAL DE ESTAÑO" que contempla los parámetros de Estaño, Azufre y Zinc siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma ISO/IEC 17043:2023.
- Proveer una herramienta objetiva para que los laboratorios participantes demuestren su competencia técnica ante entes acreditadores y demás partes interesadas.
- Promocionar a los Ensayos de Aptitud que organiza el IBMETRO como herramientas para el aseguramiento interno de la calidad de los organismos de evaluación de la conformidad nacionales.
- Fortalecer la infraestructura nacional de la calidad y la confianza de los usuarios de esta infraestructura.

5. ACTIVIDADES DE PROVEEDORES EXTERNOS

El Laboratorio de Química Inorgánica del IBMETRO preparó los ítems de ensayo para este ensayo de aptitud.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO

Identificación	Matriz	Cantidad de Muestra	Parámetros
EQI-008-2025 Mineral de Estaño 1	Mineral de Estaño	Aprox. 30 g	Estaño (1 g/100g a 15 g/100g)
EQI-008-2025 Mineral de Estaño 2	Mineral de Estaño	Aprox. 30 g	Estaño (40 g/100g a 60 g/100g) Azufre (1 g/100g a 15 g/100g) Zinc (1 g/100g a 15 g/100g)
EQI-008-2025 Mineral de Estaño 3	Mineral de Estaño	Aprox. 30 g	Estaño (65 g/100g a 85 g/100g)

Tabla 1. Descripción de los ítems de ensayo

7. HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO

La homogeneidad y la estabilidad de los ítems de ensayo de aptitud fueron evaluadas siguiendo los lineamientos de la norma ISO 17043:2023 e ISO 13528:2022 para garantizar que no tengan influencia en la evaluación de la aptitud de los participantes.

Para evaluar la homogeneidad en los ítems de ensayo de aptitud se verifica que la

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 6 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

desviación estándar de debido a la inhomogeneidad (s_s) cumpla el siguiente criterio:

$$s_s \leq 0,3 \sigma_{pt} \quad (1)$$

Para evaluar la estabilidad de los ítems de ensayo de aptitud se verifica que la incertidumbre debido a la inestabilidad (u_{stab}) cumpla el siguiente criterio:

$$u_{stab} \leq 0,3 \sigma_{pt} \quad (2)$$

Cuando no se cumpla (1) y/o (2) se procederá de acuerdo a la sección 10, para incluir la incertidumbre del valor asignado en la desviación estándar para evaluación de aptitud σ_{pt} .

Cuando la desviación estándar para la evaluación de aptitud σ_{pt} es calculada como la desviación estándar de los resultados de los participantes, los componentes de la incertidumbre debido a la inhomogeneidad, transporte e inestabilidad están en gran parte reflejados en la variabilidad de los participantes.

8. VALORES DE REFERENCIA

El valor asignado x_{pt} para cada uno de los parámetros se obtuvo a partir de la mediana de los resultados, calculada según la siguiente ecuación:

$$Mediana = X_{i\frac{n+1}{2}} \quad \text{Si "n" es impar} \quad (3)$$

$$Mediana = \frac{X_{i\frac{n}{2}} + X_{i\frac{n+1}{2}}}{2} \quad \text{Si "n" es par} \quad (4)$$

Siendo x_i el promedio individual de las mediciones de cada muestra (A y B), el cual fue calculado según la siguiente ecuación:

$$x_i = \frac{Valor_1 + Valor_2}{2} \quad (5)$$

Siendo Valor 1 y Valor 2 los resultados reportados por los laboratorios (para la muestra A y B).

Para estimar la incertidumbre del valor asignado de los ítems de ensayo en los parámetros a evaluar, se considera los siguientes aportes:

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 7 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

$$u(x_{pt}) = \sqrt{u_{char}^2 + u_{hom}^2 + u_{trans}^2 + u_{stab}^2} \quad (6)$$

Dónde:

$u(x_{pt})$ es la incertidumbre estándar del valor asignado.

u_{char} es la incertidumbre estándar de la caracterización.

u_{hom} es la incertidumbre estándar debido a las diferencias entre ítems de ensayo de aptitud ("inhomogeneidad").

u_{trans} es la incertidumbre estándar debido a la inestabilidad causada por el transporte de los ítems de ensayo de aptitud.

u_{stab} es la incertidumbre estándar de la inestabilidad durante el periodo del ensayo de aptitud.

Cuando el valor asignado ha sido calculado por consenso de los datos de participantes, la incertidumbre estándar de cada uno de los valores asignados ha sido estimada mediante la siguiente expresión:

$$u(x_{pt}) = \frac{1,25 * s^*}{\sqrt{p}} \quad (7)$$

Siendo

s^* = desviación estándar robusta

p = Número de Laboratorios participantes en el parámetro.

Cuando el valor asignado y la desviación estándar robusta en (7) son determinados con los datos de los participantes la incertidumbre del valor asignado puede asumirse que incluye los efectos de la incertidumbre debido a la inhomogeneidad, transporte e inestabilidad.

La incertidumbre del valor asignado debe cumplir que:

$$u(x_{pt}) \leq 0,3 \sigma_{pt} \quad (8)$$

Cuando no se cumpla (8) se procederá de acuerdo a la sección 10, para incluir la incertidumbre del valor asignado en la desviación estándar para evaluación de aptitud (σ_{pt}).

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 8 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

El estimador de dispersión se obtuvo del modelo general de Horwitz el cual es independiente del número de participantes.

$$\sigma_{pt} = \begin{cases} 0,22c & \text{cuando } c < 1,2 * 10^{-7} \\ 0,02c^{0,8495} & \text{cuando } 1,2 * 10^{-7} \leq c \leq 0,138 \\ 0,01c^{0,5} & \text{cuando } c > 0,138 \end{cases} \quad (9)$$

Dónde:

c = Fracción en masa

9. CONFIDENCIALIDAD

Los resultados del Ensayo de Aptitud han sido tratados con absoluta confidencialidad, cada participante fue identificado por un código individual, que solo es conocido por el laboratorio participante y por la Unidad de Coordinación del ensayo.

10. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

El tratamiento de los datos para la evaluación del desempeño estará basado en la Norma ISO 13528:2022, "Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons". El desempeño de cada laboratorio participante en el Ensayo de Aptitud será evaluado mediante el z-score.

$$z_i = \frac{x_i - x_{pt}}{\sigma_{pt}} \quad (10)$$

Dónde:

x_{pt} = Valor asignado

x_i = Resultado del participante "i"

σ_{pt} = Desviación estándar para la evaluación de la aptitud

Se determinó el valor de z-score para cada laboratorio participante. El desempeño ha sido clasificado como *satisfactorio*, *cuestionable*, *insatisfactorio*, a partir de la interpretación de este parámetro. A menor valor absoluto de "z" mejor es el desempeño del laboratorio.

- Satisfactorios: $|z|$ menor o igual a 2
- Cuestionables: $|z|$ mayor a 2 y menor a 3
- Insatisfactorios: $|z|$ mayor o igual a 3

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 9 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

Cuanto menor sea el valor absoluto de "z", mejor será el desempeño del laboratorio.

Para los parámetros en los que la incertidumbre sea significativa respecto al estimador de la dispersión de los laboratorios y se cumpla que:

$$u(x_{pt}) > 0,3 * \sigma_{pt} \quad (11)$$

Se considerará la incertidumbre para expandir el denominador del estadístico de desempeño. Este estadístico se llama z' y se calcula de la siguiente manera:

$$z'_i = \frac{x_i - x_{pt}}{\sqrt{\sigma_{pt}^2 + u^2(x_{pt})}} \quad (12)$$

Dónde:

x_{pt} = Valor asignado

x_i = Resultado del participante "i"

σ_{pt} = Desviación estándar para la evaluación de la aptitud

$u(x_{pt})$ = Incertidumbre estándar del valor asignado

Para el cálculo de la incertidumbre expandida se considera un factor de cobertura k=2.

$$U(x_{pt}) = k * u(x_{pt}) \quad (13)$$

11. RESULTADOS

11.1. Estaño en Mineral de Estaño 1

Parámetro	Valor asignado			
	Valor (g/100 g)	Dispersión (σ_{pt})	Incertidumbre Expandida (g/100 g)	Desviación estándar para evaluación de la aptitud (σ_{pt}')
Estaño	3,33	0,111	0,28	0,179

Tabla 2. Valor asignado, estadístico de dispersión para la evaluación de desempeño e incertidumbre expandida.

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 10 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

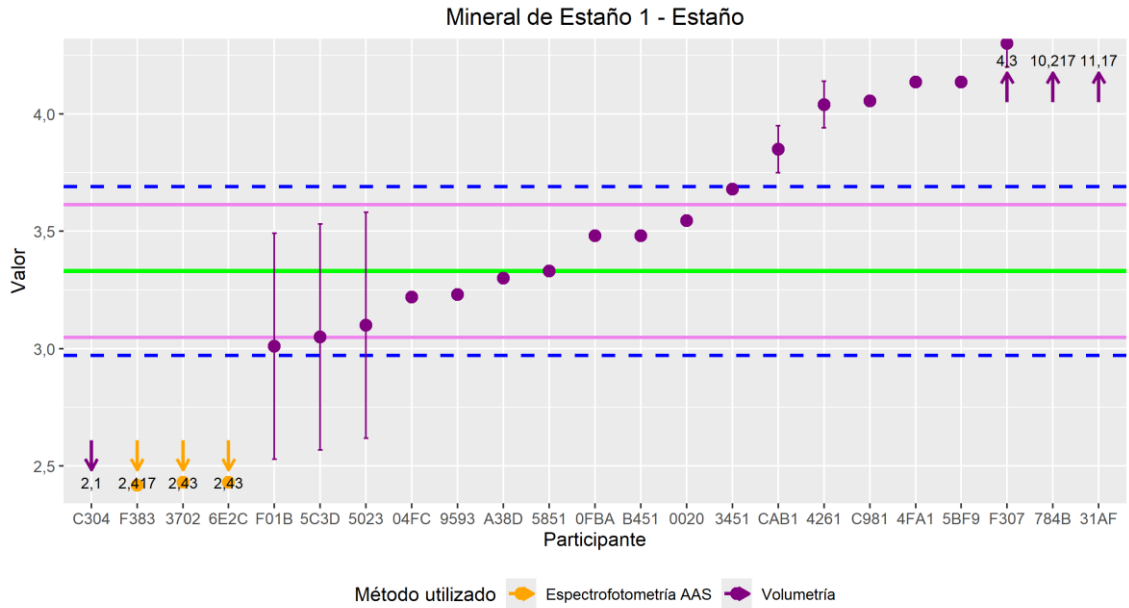


Gráfico 1. Valores reportados por los participantes (puntos negros), incertidumbres asociadas (barras negras), valor asignado (línea verde), estadístico de dispersión multiplicado por 2 (línea segmentada azul) e incertidumbre expandida (línea violeta).

En la siguiente figura se muestran la evaluación del desempeño de los participantes, de forma gráfica.

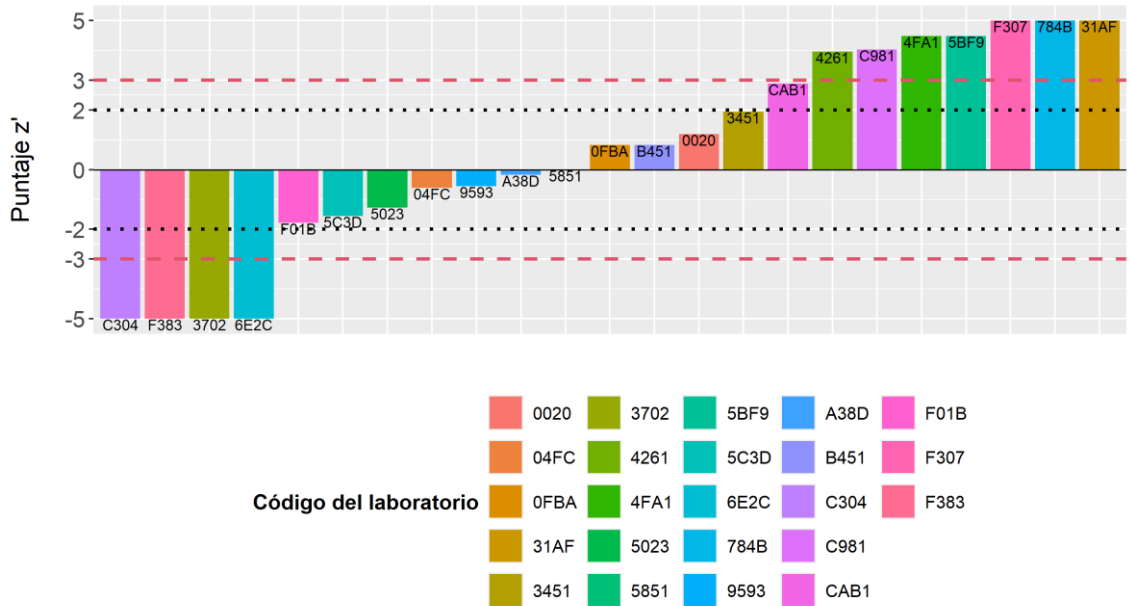


Gráfico 2. Evaluación de desempeño de los participantes (Nota. Los valores insatisfactorios que salen de la escala no son visualizados).

En el siguiente cuadro se resume la información más relevante de la evaluación del desempeño de los participantes.

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 11 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

Participante	Resultado reportado (g/100g)	Incertidumbre expandida U (k=2) (g/100g)	Puntaje z'	Resultado de evaluación
C304	2,100	NA	-6,83	Insatisfactorio
F383	2,417	NA	-5,07	Insatisfactorio
6E2C	2,430	NA	-5,00	Insatisfactorio
3702	2,430	NA	-5,00	Insatisfactorio
F01B	3,010	0,481	-1,78	Satisfactorio
5C3D	3,050	0,481	-1,56	Satisfactorio
5023	3,100	0,481	-1,28	Satisfactorio
04FC	3,220	NA	-0,61	Satisfactorio
9593	3,230	NA	-0,56	Satisfactorio
A38D	3,300	NA	-0,17	Satisfactorio
5851	3,330	NA	0,00	Satisfactorio
0FBA	3,480	NA	0,83	Satisfactorio
B451	3,480	NA	0,83	Satisfactorio
0020	3,545	NA	1,19	Satisfactorio
3451	3,680	NA	1,94	Satisfactorio
CAB1	3,850	0,100	2,89	Cuestionable
4261	4,040	0,100	3,95	Insatisfactorio
C981	4,055	NA	4,03	Insatisfactorio
5BF9	4,135	NA	4,47	Insatisfactorio
4FA1	4,135	NA	4,47	Insatisfactorio
F307	4,300	0,100	5,39	Insatisfactorio
784B	10,217*	NA	38,27	Insatisfactorio
31AF	11,170*	NA	43,57	Insatisfactorio

Tabla 3. Códigos de participantes, resultados reportados, estadístico de evaluación y resultado de la Evaluación de desempeño (valores marcados con * fueron considerados atípicos y no fueron considerados en el cálculo de valores por consenso) (NA = No reportó).

11.2. Estaño en Mineral de Estaño 2

Parámetro	Valor asignado			
	Valor (g/100 g)	Dispersión (σ_{pt})	Incertidumbre Expandida (g/100 g)	Desviación estándar para evaluación de la aptitud (σ_{pt})
Estaño	55,26	0,743	0,24	0,743

Tabla 4. Valor asignado, estadístico de dispersión para la evaluación de desempeño e incertidumbre expandida.

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 12 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

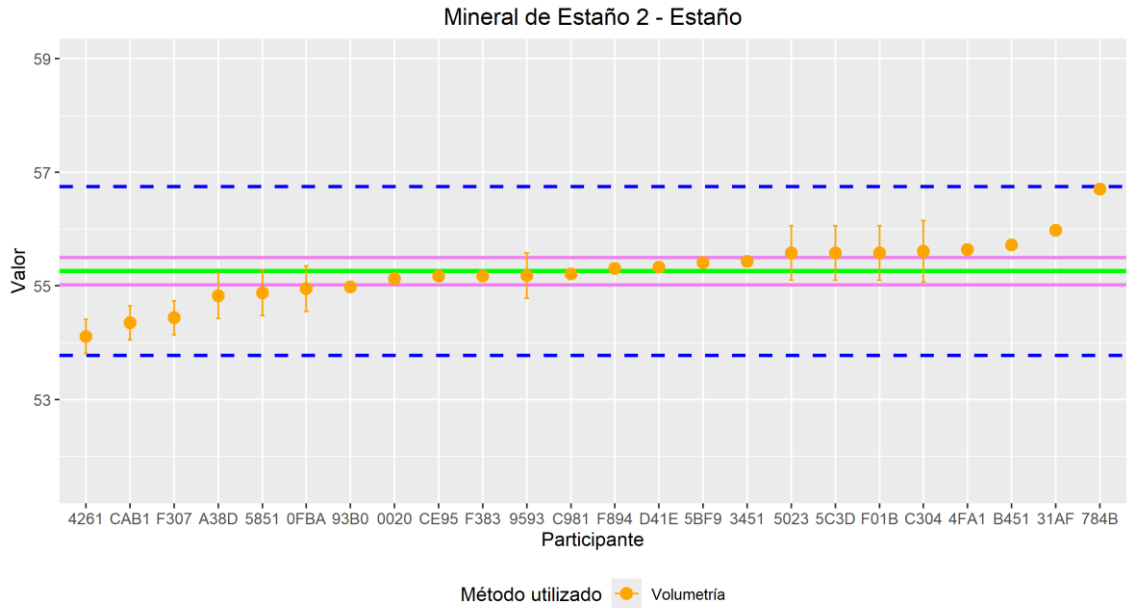


Gráfico 3. Valores reportados por los participantes (puntos negros), incertidumbres asociadas (barras negras), valor asignado (línea verde), estadístico de dispersión multiplicado por 2 (línea segmentada azul) e incertidumbre expandida (línea violeta).

En la siguiente figura se muestran la evaluación del desempeño de los participantes, de forma gráfica.

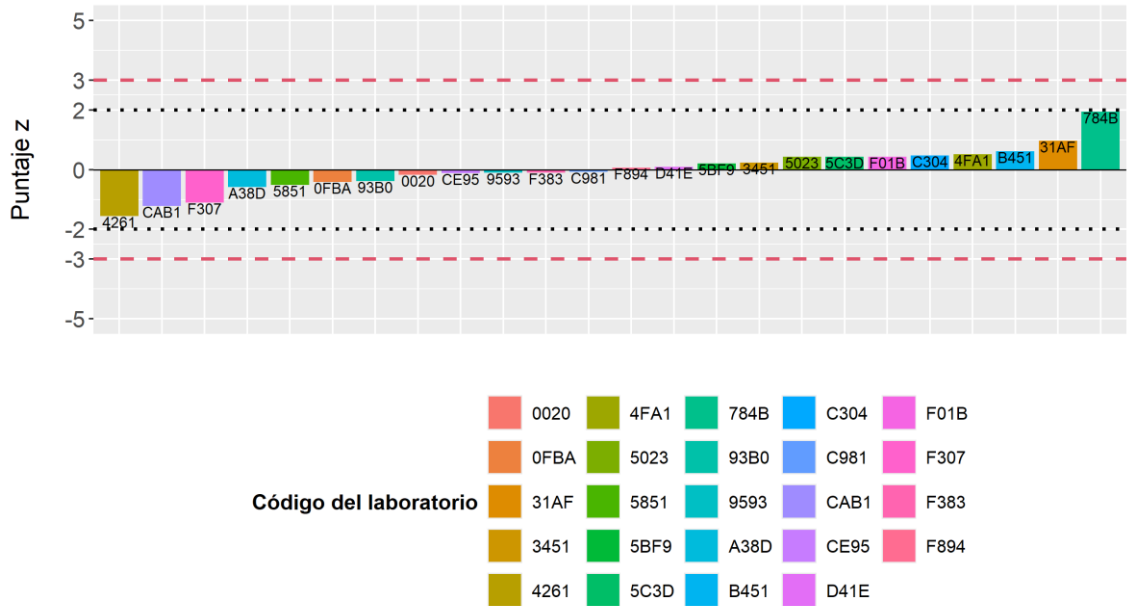


Gráfico 4. Evaluación de desempeño de los participantes (Nota. Los valores insatisfactorios que salen de la escala no son visualizados).

En el siguiente cuadro se resume la información más relevante de la evaluación del desempeño de los participantes.

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 13 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

Participante	Resultado reportado (g/ 100g)	Incertidumbre expandida U (k=2) (g/100g)	Puntaje z	Resultado de evaluación
4261	54,110	0,300	-1,55	Satisfactorio
CAB1	54,350	0,300	-1,22	Satisfactorio
F307	54,440	0,300	-1,10	Satisfactorio
A38D	54,825	0,400	-0,59	Satisfactorio
5851	54,880	0,400	-0,51	Satisfactorio
0FBA	54,950	0,400	-0,42	Satisfactorio
93B0	54,980	NA	-0,38	Satisfactorio
0020	55,130	NA	-0,17	Satisfactorio
CE95	55,170	NA	-0,12	Satisfactorio
F383	55,175	NA	-0,11	Satisfactorio
9593	55,180	0,400	-0,11	Satisfactorio
C981	55,210	NA	-0,07	Satisfactorio
F894	55,310	NA	0,07	Satisfactorio
D41E	55,330	NA	0,09	Satisfactorio
5BF9	55,410	NA	0,20	Satisfactorio
3451	55,430	NA	0,23	Satisfactorio
F01B	55,580	0,481	0,43	Satisfactorio
5023	55,580	0,481	0,43	Satisfactorio
5C3D	55,580	0,481	0,43	Satisfactorio
C304	55,607	0,540	0,47	Satisfactorio
4FA1	55,640	NA	0,51	Satisfactorio
B451	55,720	NA	0,62	Satisfactorio
31AF	55,980	NA	0,97	Satisfactorio
784B	56,700	NA	1,94	Satisfactorio

Tabla 5. Códigos de participantes, resultados reportados, estadístico de evaluación y resultado de la Evaluación de desempeño (NA = No reportó).

11.3. Azufre en Mineral de Estaño 2

Parámetro	Valor asignado			
	Valor (g/100 g)	Dispersión (σ_{pt})	Incertidumbre Expandida (g/100 g)	Desviación estándar para evaluación de la aptitud (σ_{pt}')
Azufre	6,42	0,193	0,54	0,334

Tabla 6. Valor asignado, estadístico de dispersión para la evaluación de desempeño e incertidumbre expandida.

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 14 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	Nº de Registro: 022/2025

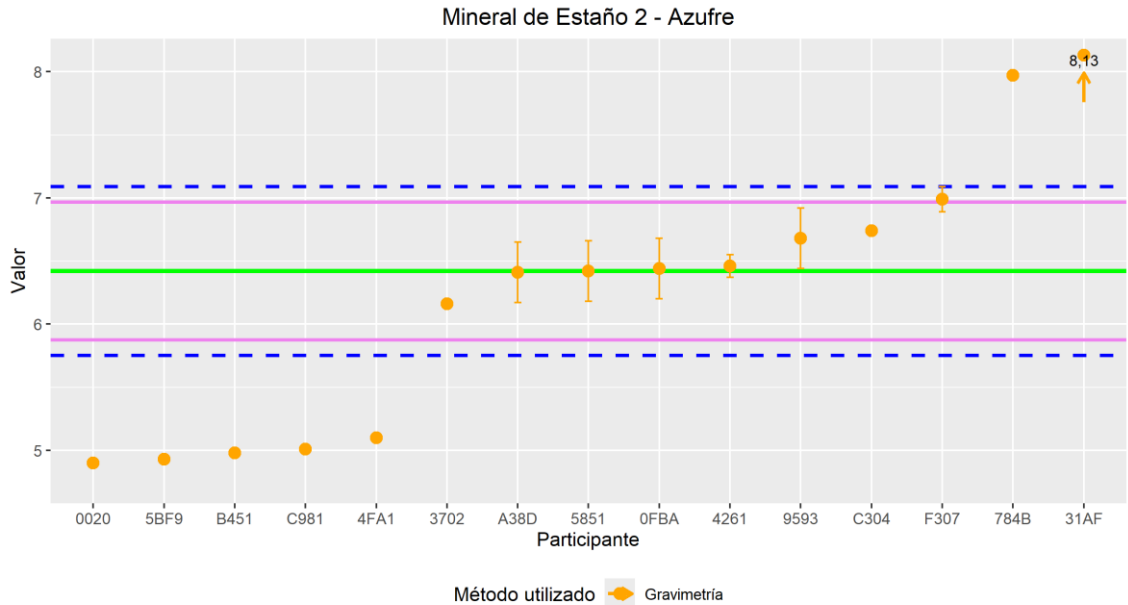


Gráfico 5. Valores reportados por los participantes (puntos negros), incertidumbres asociadas (barras negras), valor asignado (línea verde), estadístico de dispersión multiplicado por 2 (línea segmentada azul) e incertidumbre expandida (línea violeta).

En la siguiente figura se muestran la evaluación del desempeño de los participantes, de forma gráfica.

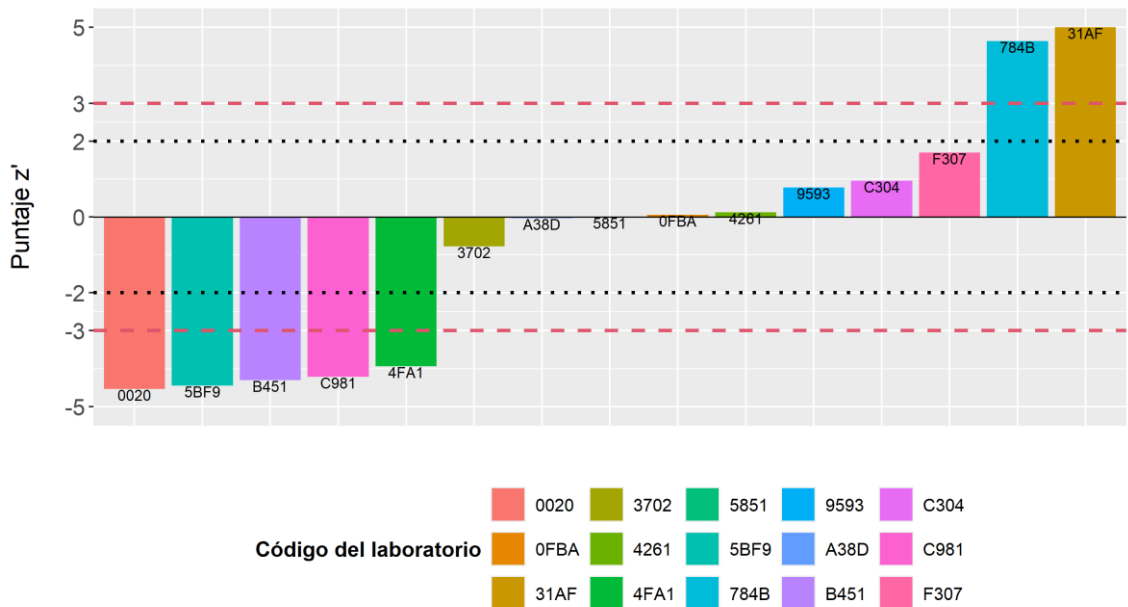


Gráfico 6. Evaluación de desempeño de los participantes (Nota. Los valores insatisfactorios que salen de la escala no son visualizados).

En el siguiente cuadro se resume la información más relevante de la evaluación del desempeño de los participantes.

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 15 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

Participante	Resultado reportado (g/ 100g)	Incertidumbre expandida U (k=2) (g/100g)	Puntaje z'	Resultado de evaluación
0020	4,900	NA	-4,54	Insatisfactorio
5BF9	4,930	NA	-4,45	Insatisfactorio
B451	4,980	NA	-4,30	Insatisfactorio
C981	5,010	NA	-4,21	Insatisfactorio
4FA1	5,100	NA	-3,94	Insatisfactorio
3702	6,160	NA	-0,78	Satisfactorio
A38D	6,410	0,24	-0,03	Satisfactorio
5851	6,420	0,24	0,00	Satisfactorio
0FBA	6,440	0,24	0,06	Satisfactorio
4261	6,460	0,09	0,12	Satisfactorio
9593	6,680	0,24	0,78	Satisfactorio
C304	6,740	NA	0,96	Satisfactorio
F307	6,990	0,10	1,70	Satisfactorio
784B	7,971	NA	4,64	Insatisfactorio
31AF	8,130	NA	5,11	Insatisfactorio

Tabla 7. Códigos de participantes, resultados reportados, estadístico de evaluación y resultado de la Evaluación de desempeño (NA = No reportó).

11.4. Zinc en Mineral de Estaño 2

Parámetro	Valor asignado			
	Valor (g/100 g)	Dispersión (σ_{pt})	Incertidumbre Expandida (g/100 g)	Desviación estándar para evaluación de la aptitud (σ_{pt}')
Zinc	4,85	0,152	0,12	0,166

Tabla 8. Valor asignado, estadístico de dispersión para la evaluación de desempeño e incertidumbre expandida.

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 16 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	Nº de Registro: 022/2025

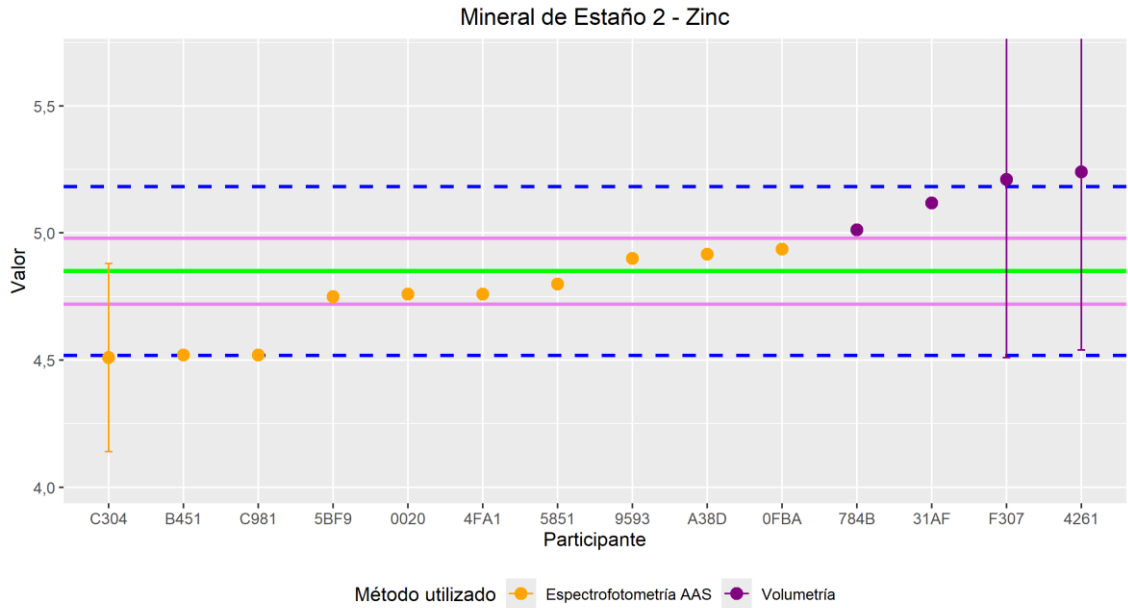


Gráfico 7. Valores reportados por los participantes (puntos negros), incertidumbres asociadas (barras negras), valor asignado (línea verde), estadístico de dispersión multiplicado por 2 (línea segmentada azul) e incertidumbre expandida (línea violeta).

En la siguiente figura se muestran la evaluación del desempeño de los participantes, de forma gráfica.

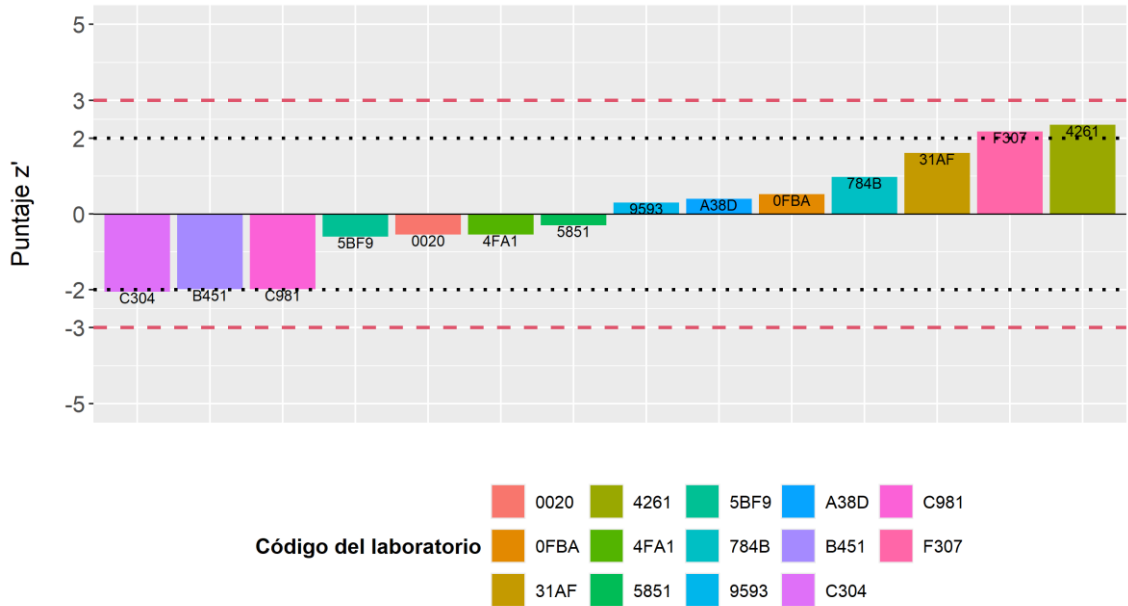


Gráfico 8. Evaluación de desempeño de los participantes (Nota. Los valores insatisfactorios que salen de la escala no son visualizados).

En el siguiente cuadro se resume la información más relevante de la evaluación del desempeño de los participantes.

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 17 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

Participante	Resultado reportado (g/ 100g)	Incertidumbre expandida U (k=2) (g/100g)	Puntaje z'	Resultado de evaluación
C304	4,510	0,37	-2,05	Cuestionable
B451	4,520	NA	-1,99	Satisfactorio
C981	4,520	NA	-1,99	Satisfactorio
5BF9	4,750	NA	-0,60	Satisfactorio
0020	4,760	NA	-0,54	Satisfactorio
4FA1	4,760	NA	-0,54	Satisfactorio
5851	4,800	NA	-0,30	Satisfactorio
9593	4,900	NA	0,30	Satisfactorio
A38D	4,916	NA	0,40	Satisfactorio
0FBA	4,936	NA	0,52	Satisfactorio
784B	5,012	NA	0,98	Satisfactorio
31AF	5,118	NA	1,61	Satisfactorio
F307	5,210	0,70	2,17	Cuestionable
4261	5,240	0,70	2,35	Cuestionable

Tabla 9. Códigos de participantes, resultados reportados, estadístico de evaluación y resultado de la Evaluación de desempeño (NA = No reportó).

11.5. Estaño en Mineral de Estaño 3

Parámetro	Valor asignado			
	Valor (g/100 g)	Dispersión (σ_{pt})	Incertidumbre Expandida (g/100 g)	Desviación estándar para evaluación de la aptitud (σ_{pt})
Estaño	71,70	0,846	0,09	0,846

Tabla 10. Valor asignado, estadístico de dispersión para la evaluación de desempeño e incertidumbre expandida.

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 18 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	Nº de Registro: 022/2025

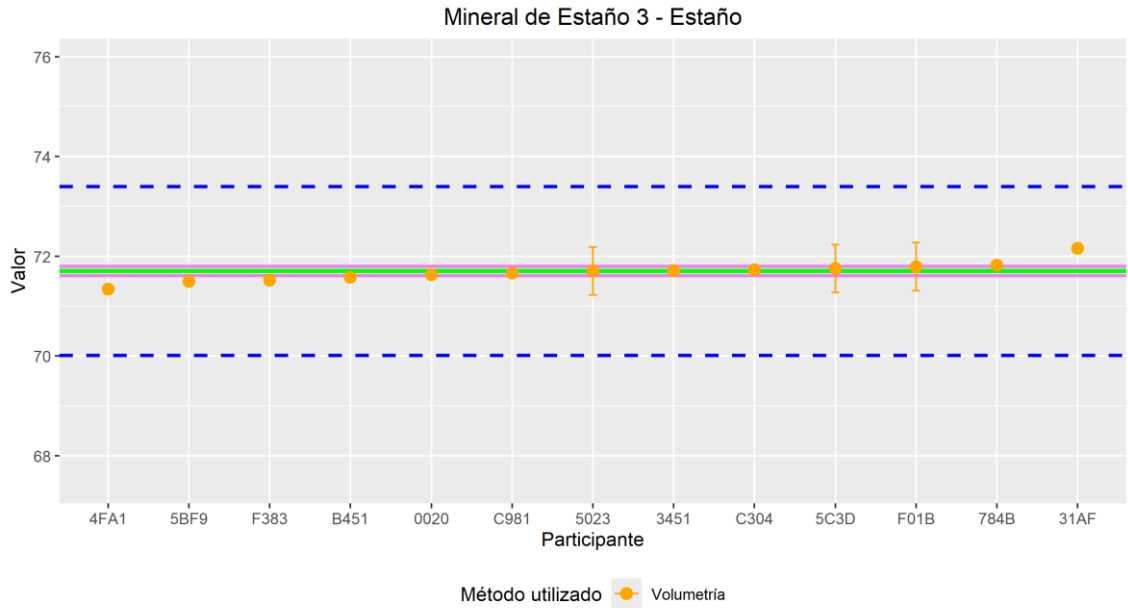


Gráfico 9. Valores reportados por los participantes (puntos negros), incertidumbres asociadas (barras negras), valor asignado (línea verde), estadístico de dispersión multiplicado por 2 (línea segmentada azul) e incertidumbre expandida (línea violeta).

En la siguiente figura se muestran la evaluación del desempeño de los participantes, de forma gráfica.

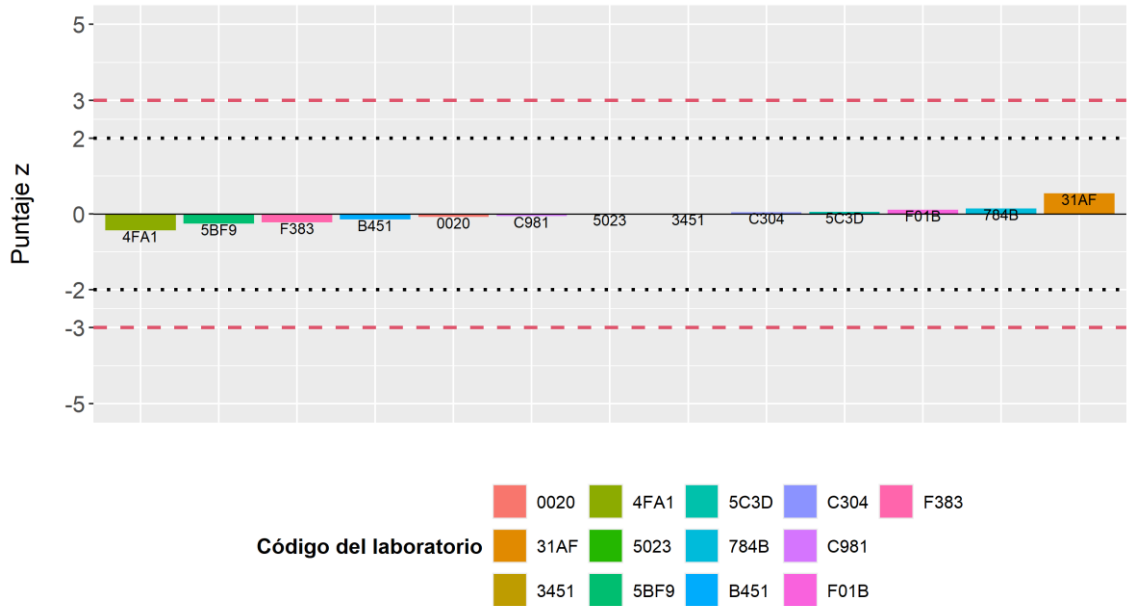


Gráfico 10. Evaluación de desempeño de los participantes (Nota. Los valores insatisfactorios que salen de la escala no son visualizados).

En el siguiente cuadro se resume la información más relevante de la evaluación del desempeño de los participantes.

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 19 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

Participante	Resultado reportado (g/ 100g)	Incertidumbre expandida U (k=2) (g/100g)	Puntaje z	Resultado de evaluación
4FA1	71,340	NA	-0,43	Satisfactorio
5BF9	71,490	NA	-0,25	Satisfactorio
F383	71,517	NA	-0,22	Satisfactorio
B451	71,580	NA	-0,14	Satisfactorio
0020	71,630	NA	-0,08	Satisfactorio
C981	71,660	NA	-0,05	Satisfactorio
5023	71,700	0,481	0,00	Satisfactorio
3451	71,710	NA	0,01	Satisfactorio
C304	71,730	NA	0,04	Satisfactorio
5C3D	71,750	0,481	0,06	Satisfactorio
F01B	71,790	0,481	0,11	Satisfactorio
784B	71,823	NA	0,15	Satisfactorio
31AF	72,160	NA	0,54	Satisfactorio

Tabla 11. Códigos de participantes, resultados reportados, estadístico de evaluación y resultado de la Evaluación de desempeño (NA = No reportó).

12. LABORATORIOS PARTICIPANTES

En este ensayo de aptitud se registró la participación de 10 laboratorios de diferentes departamentos de Bolivia. Es importante resaltar que la numeración de la tabla N° 12 es solamente un indicativo del número de laboratorios participantes en el presente Ensayo, no está asociada a los códigos de participación de los laboratorios.

Nº	INSTITUCIÓN	DEPARTAMENTO
1	EMPRESA MINERA HUANUNI	Oruro
2	IMPALA TERMINALS BOLIVIA SERVICIOS LOGISTICOS S. A.	Oruro
3	LABORATORIO DE ENSAYOS VINTO DE LA EMPRESA METALÚRGICA VINTO	Oruro
4	LABORATORIO DE MINERALES "LAB-MIN"	Oruro
5	LABORATORIO QUIMICO CONDE MORALES	Oruro
6	LABORATORIO QUIMICO DE CHIRIPUJIO SERGEOMIN	Oruro
7	LABORATORIO QUÍMICO DON DIEGO SINCHI WAYRA S.A.	Potosí
8	LABORATORIO QUÍMICO-EMPRESA MINERA COLQUIRI	La Paz
9	SERVICIOS INTEGRADOS DE LABORATORIO LABSIC SRL	La Paz
10	SPECTROLAB	Oruro

Tabla 12. Participantes del Ensayo de Aptitud EQI-008-2025 Determinación de elementos en Mineral de Estaño.

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 20 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

13. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS LABORATORIOS

- Ningún laboratorio participante reportó algún inconveniente con el estado de los ítems de ensayo una vez que llegaron a sus instalaciones.
- Los participantes usaron métodos volumétricos y de espectrofotometría de Absorción Atómica para la medición de Estaño, Azufre y Zinc en Mineral de Estaño.
- Se recomienda a los participantes la implementación de la estimación de la incertidumbre de sus mediciones ya que la incertidumbre es un parámetro importante asociado al resultado de una medición, la cual caracteriza la dispersión de los valores que pueden ser razonablemente atribuidos al mensurando.

14. CONCLUSIONES

- Se logró brindar a los participantes una herramienta para evaluar su desempeño y demostrar su competencia técnica para realizar los ensayos en la Determinación de Elementos en Mineral de Estaño en el presente ensayo de aptitud.
- El diseño estadístico y los criterios de evaluación utilizados por el IBMETRO como proveedor fueron adecuados para el propósito del ensayo de aptitud.
- Se recomienda, cuando sea posible, el uso de materiales de referencia certificados, uso de materiales de control de calidad, entre otros, según lo recomendado en la norma ISO/IEC 17025 para el aseguramiento de la calidad de las mediciones.
- Se sugiere en todos los casos, la validación del método de ensayo, la implementación de un procedimiento de control interno de calidad, el control metrológico de los equipos.
- Se recomienda realizar una evaluación del sesgo de las mediciones con el fin de tomar acciones de mejora que puedan ayudar a corregir los errores sistemáticos asociados a una medición.
- Se recomienda la participación rutinaria en Rondas de Ensayos de Aptitud con el fin de demostrar su mejora o para demostrar la permanencia de su buen desempeño. La Unidad de Metrología Química y el Comité Científico Técnico agradecen el interés y la colaboración de los participantes en la realización de este Ensayo de Aptitud.

15. APELACIONES

En caso de desacuerdo con los resultados de la evaluación de desempeño, y siempre que se cuente con evidencia objetiva que lo respalde, el participante

DMIC-EA-PE-001/F06	FORMULARIO	
V.02	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE APTITUD	
Página 21 de 21	Vigente desde: 2024-10-15	N° de Registro: 022/2025

podrá presentar una apelación mediante el envío de un correo a calidad@ibmetro.gob.bo

16. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

ISO/IEC 17043:2023. "Conformity assessment – General requirements for the competence of proficiency testing providers".

ISO 13528:2022. "Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons"

NB/ISO/IEC 17025:2018. "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

Thompson, M., Ellison, S. L., & Wood, R. (2006). The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry, 78(1), 145-196

Guía para la expresión de la incertidumbre de medida. BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, OIML. Organización Internacional de Normalización, impresa en Suiza, ISBN 92-67-10188-9, primera edición, 1993. Corregida y reimpressa en 1995.

ISO 33405:2024. Reference materials – Approaches for characterization and assessment of homogeneity and stability.

ISO 16269-4:2010. Statistical interpretation of data Part 4: Detection and treatment of outliers.